

**Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 1: Všeobecné požadavky na základní
bezpečnost a nezbytnou funkčnost**

**ČSN
EN 60601-1
ed. 2/A1
OPRAVA 1
36 4801**

idt IEC 60601-1:2005/A1:2012/Cor.1:2014-07


Corrigendum


Tato oprava ČSN EN 60601-1 ed. 2:2007/A1:2014 je českou verzí opravy EN 60601-1:2006/A1:2013/AC:2014-07. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60601-1 ed. 2:2007/A1:2014 is the Czech version of the Corrigendum EN 60601-1:2006/A1:2013/AC:2014-07. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60601-1 ed. 2/A1 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost z června 2014 se opravuje takto:

V části b) obrázku 12 v popisu svislé osy kmitočtové charakteristiky se „^{a)} dB: 20 log“ nahrazuje „^{c)} (dB): 20 log“ takto:

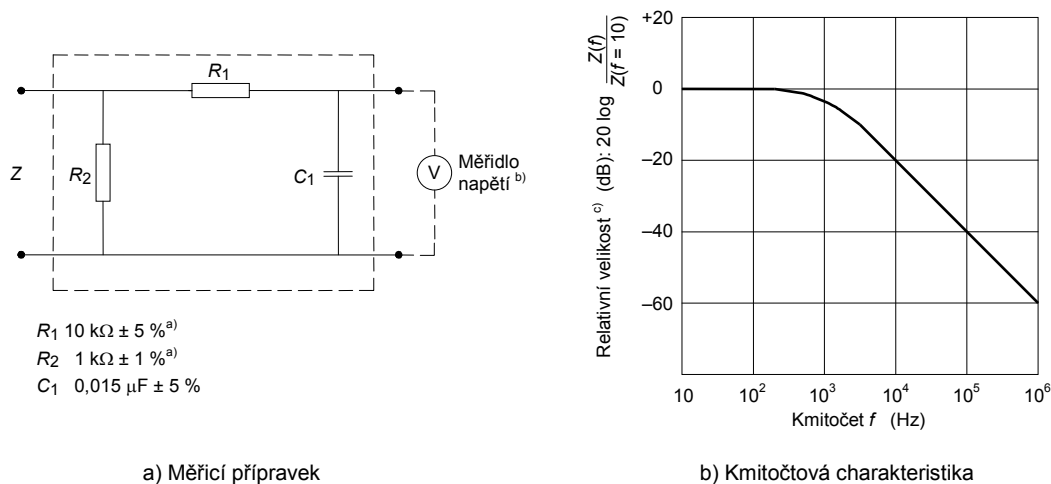

POZNÁMKA V následujících obrázcích je výše uvedený obvod včetně měřidla napětí nahrazen značkou .

- a) Bezindukční součásti.
- b) Odpor \geq 1 M Ω a kapacita \leq 150 pF.
- c) $Z(f)$ je přenosová impedance obvodu, tj. V_{out}/I_{in} , pro proud o kmitočtu f .

Obrázek 12 – Příklad měřicího přípravku a jeho kmitočtová charakteristika

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 60601-1 ed. 2/A1 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2016, 2 strany

99708 Cenová skupina 998

